


NUTRICAIR®
ENTERAL

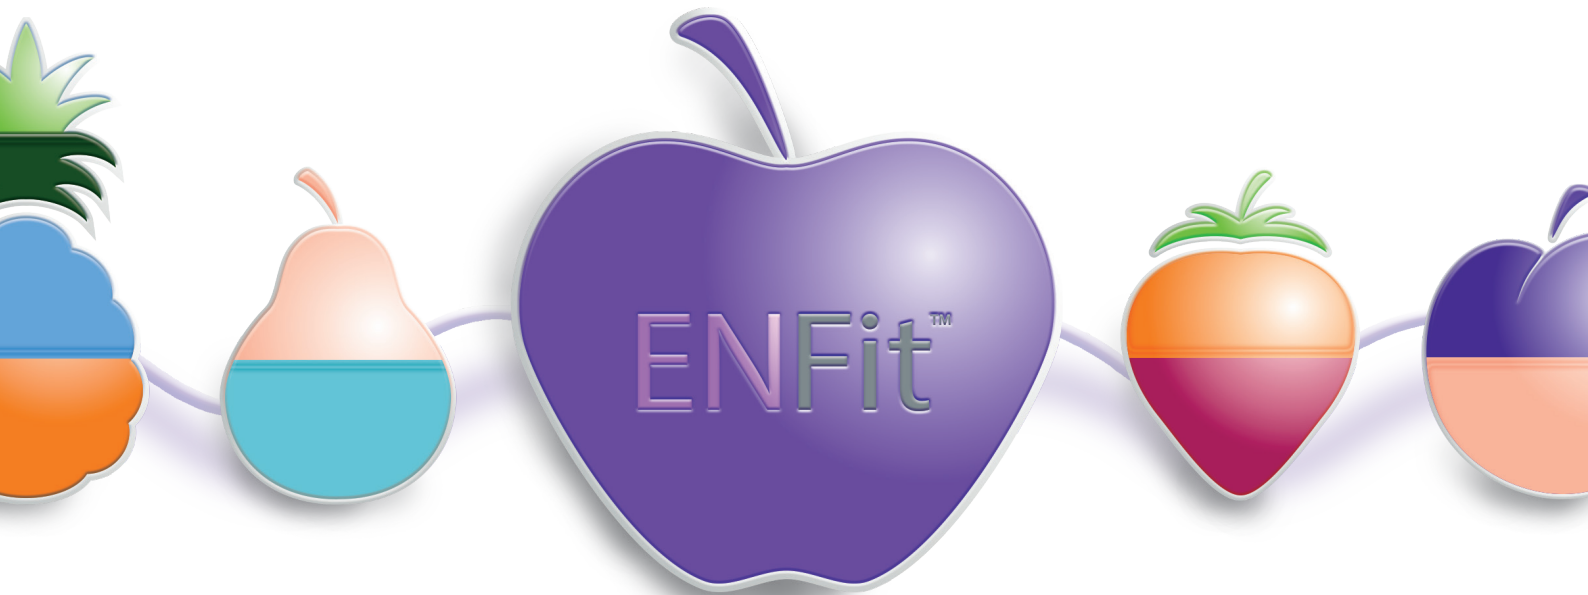

*Enteral nutrition
på ett säkert sätt*

● **CAIR LGL:s åtagande:**

- » Anpassade lösningar som är skräddarsydda efter sjukvårdsrutiner och patienter,
- » Passion för innovation och engagemang för att förbättra vårdkvaliteten,
- » Historien om män och kvinnor som brinner för att ta itu med nya utmaningar.

● **CAIR LGL:s kapacitet idag:**

500
anställda




4
tillverknings-
anläggningar




En global närvaro
in fler än 60
länder

> 80
distributörer

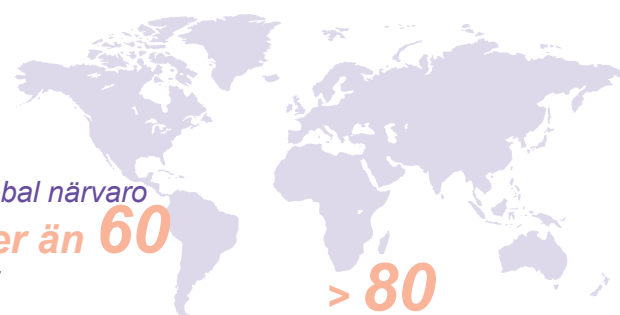

5 dotterbolag

Frankrike Italien Spanien Belgien Singapore



**Fler än
80 miljoner**

produkter sålda varje år

**Fler än
1000**

referenser av
medicinska artiklar

**3
produktlinjer**

- Infusion / Kemoterapi
- Nutrition
- Sug / Ventilation

● **CAIR LGL:**

- » Genom att implementera alla färdigheter för att utveckla produkter som uppfyller behoven hos patienter och sjukvårdspersonal inom områdena för infusion, kemoterapi, nutrition, sug och ventilation.

● **CAIR LGL:s know-how och expertis:**

Med ett komplett sortiment av enheter för säker administration:

- » inom infusion med NEUTRACLEAR™,
- » inom kemoterapi med CHEMO-DRIVE,
- » och nu inom nutrition med NUTRICAIR® Enteral.

Felkopplade slangar: ett globalt problem inom sjukvården

● ALLVARLIGA OCH UNDERRAPPORTERADE^(1,2,4)

Kan leda till allvarliga incidenter som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall⁽⁴⁾.

● HUVUDSAKLIG BIDRAGANDE FAKTOR: FYSISK KOMPATIBILITET⁽³⁾

- » Kompatibla slangar mellan ej relaterade tillförselsystem⁽⁴⁾,
- » Luer-anslutningar i en rad olika icke-IV-enheter, som möjliggör oavsiktliga anslutningar mellan olika system som har olika funktioner^(1,2,3).

● REKOMMENDATIONER FRÅN KLINISKA NUTRITIONSEXPERTER

- » Specifik och dedikerad enteral anslutning⁽⁴⁾,
- » Unik enteral anslutning för alla patienter: spädbarn, för tidigt födda, vuxna^(5,7),
- » Ej inbördes anslutningsbar och reverserad anslutning⁽⁶⁾.



Behov av en effektiv och global enteral-specifik lösning

NUTRICAIR[®]

ENTERAL *med* ENFit[™]

*Nya Cair LGL:s svar för
att förbättra och göra
sjukvårdsrutiner säkrare*





NUTRICAIR® ENTERAL *med* ENFit™

SORTIMENTET



SÄKER



NUTRICAIR® ENTERAL UPPFYLLER DE SENASTE INERNATIONELLA KRAVEN FÖR SÄKERHET, definierade av ISO-standard.

Unika utformningar av enterala anslutningar,

ej kompatibla med andra icke-enterala anslutningar^{*(2,4)}.

Fast material, vilket undviker vridning och forcering^(2,4,8).

Skruv- och reverserat system: hankoppling mot patient, honkoppling mot nutrition eller läkemedel^(2,6,9).

NUTRICAIR® ENTERAL med ENFit uppfyller kriterierna för säkra och ej inbördes anslutningsbara anslutningar från ISO 80369-1 standarder.

* Standardiserade anslutningar beskrivs i ISO 80369-1 serien.



SKRÄDDARSYDD



NUTRICAIR® ENTERAL INFÖRLIVAR CAIR LGL:S KNOW-HOW, KRAV OCH EXPERTIS FÖR SÄKER ENTERAL NUTRITION

- » Beprövad erfarenhet av säkra enterala system,
- » Kunskap om användarbehov och sjukvårdsrutiner.



ETT KOMPLETT NUTRICAIR® ENTERAL-SORTIMENT FRÅN FÖRBEREDELSE TILL TILLFÖRSEL

- » Matningssonder som är skräddarsydda efter varje patients behov

Barn:

Storlek från 4 till 10 French,
Längd från 40 cm till 125 cm

Vuxen:


Storlek från 6 till 20 French,
Längd från 110 cm till 130 cm


Barn:

Siffermarkeringar varje centimeter*

Vuxen:

Markeringar varje centimeter,
siffermarkeringar var 5:e centimeter

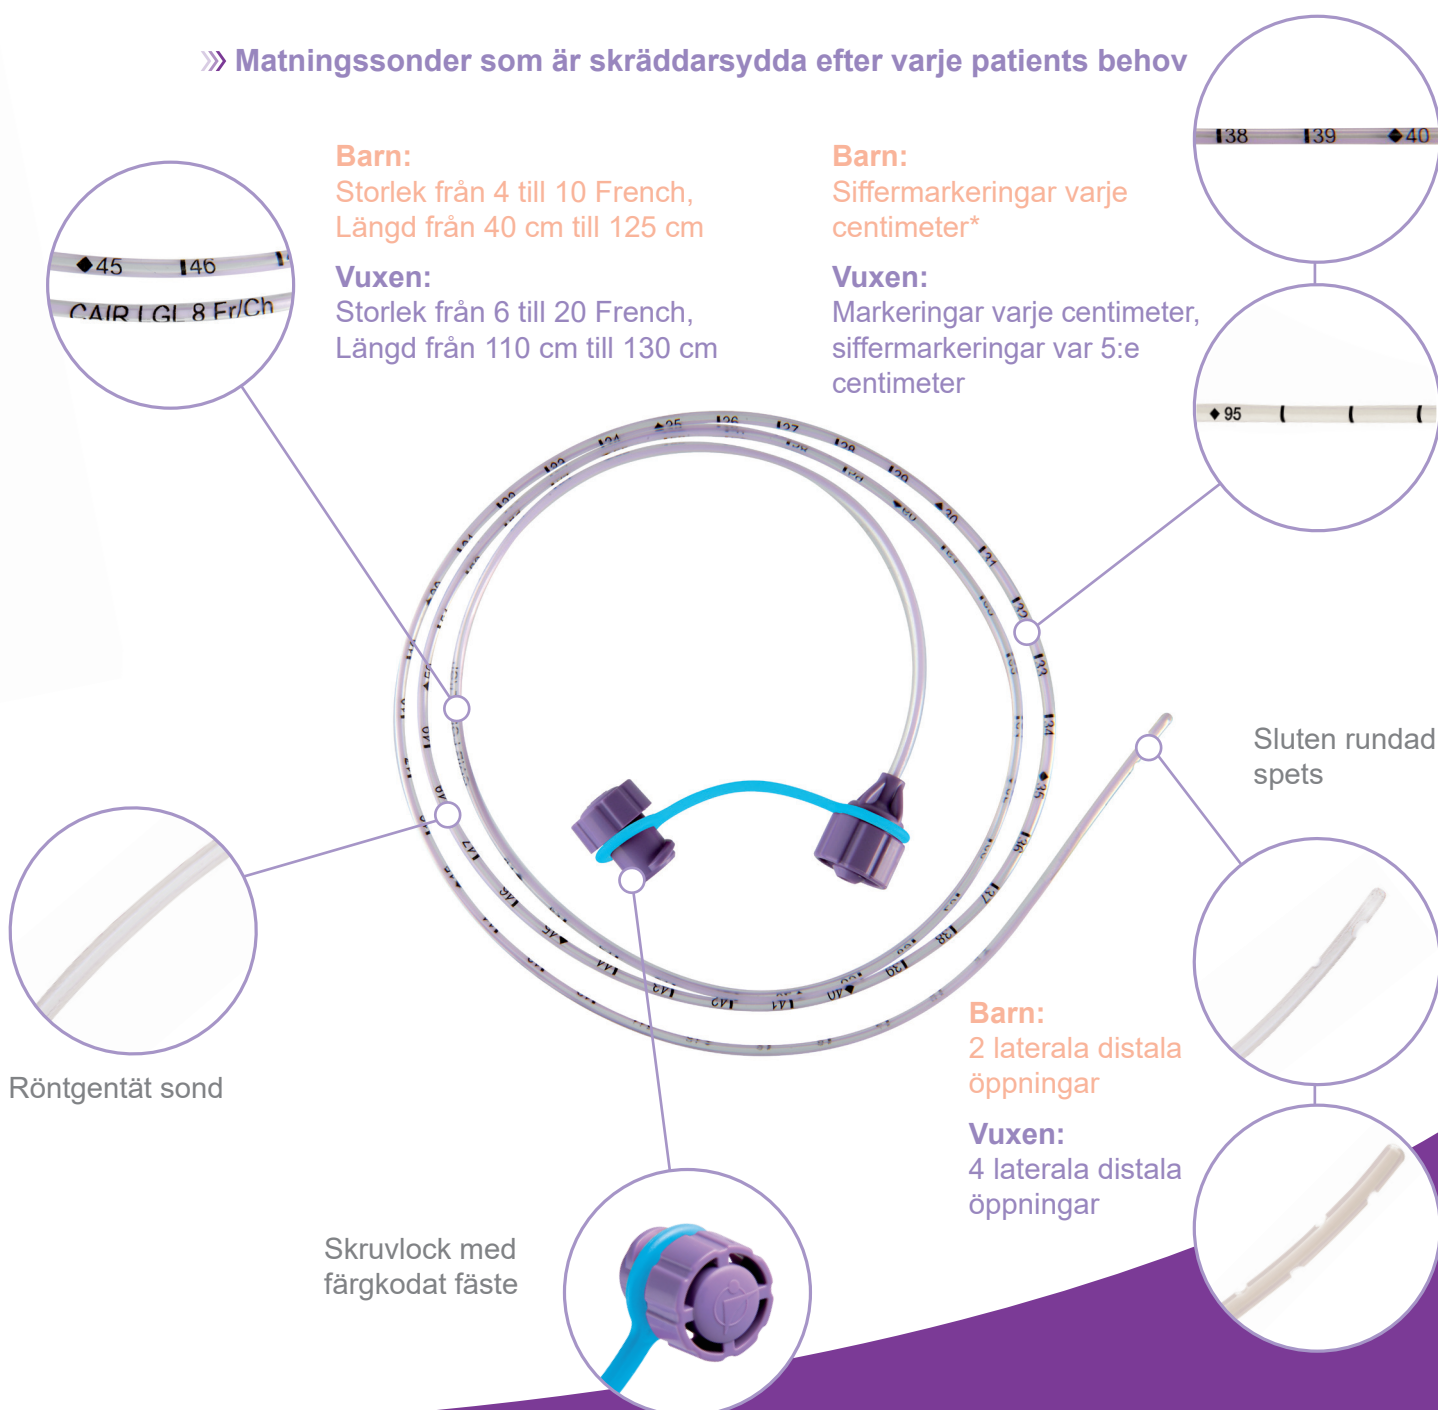

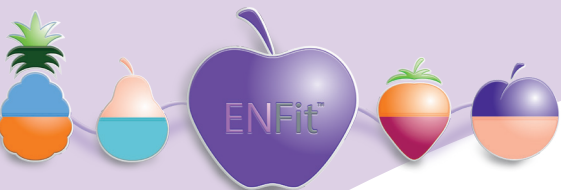

» Sprutor från 1 ml till 50/60 ml för enteral mediciner, spolning, gastrisk residual och bröstmjölk eller enteral matningsadministrering genom gravitation, bolus eller sprutpump.

1 ml Low Dose Tip spruta
2.5 ml Low Dose Tip spruta
5 ml spruta
med centrerad ENFit-spets



Sprutor på 10 ml, 20 ml och 50/60 ml
med excentrisk ENFit-spets och
dubbel markering för positionering av
sprutpump



Sprutkit och tillbehör för
daglig enteral nutrition



Sprutskruvkork

» ENFit-provtagningsenhet för mjölk eller läkemedel, för optimala hygien- och doseringsrutiner



Flasklock




Uppdragningsrör

» ENFit tillbehör för specifika patientbehov



Förlängningsset

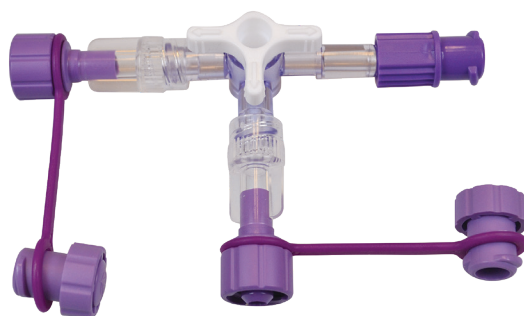

3-vägskran



Y-portsanslutningar

NUTRICAIR® ENTERAL tryggar matningsrutinerna för alla dina patienter



ENKELT & INTUITIVT



ENKLA ATT KÄNNA IGEN OCH IDENTIFIERA

- » En specifik CAIR LGL-design,
- » En färgkod för varje French-storlek
- » French-storlekarna är tydligt markerade på sondaerna.



EN ICKE-TRAUMATISK ANSLUTNING

- » Mjuka kurvor och rundad design, som är anpassad till såväl patienternas som sjukvårdspersonalens behov.



EN ERGONOMISK ANSLUTNING FÖR OPTIMERAD HANTERING

- » En design med greppzoner som underlättar på- och urskruvning,
- » En lämplig form och storlek som uppfyller ISO-kraven.

NUTRICAIR®
ENTERAL_{med} ENFit™

Kombinationen av CAIR LGL:s färdigheter och expertis uppfyller nya ISO-krav och erbjuder ett komplett, säkert och skräddarsytt sortiment för dina sjukvårdsrutiner och behov.

Det nya sortimentet **NUTRICAIR®**

ENTERAL_{med} ENFit™

NUTRICAIR® ENTERAL NASOGASTRISKA SONDER - NEONATOLOGI/PEDIATRIK



Transparent sond med röntgentät linje, siffermarkeringar vid varje centimeter (från 5 till 75 cm), sluten rundad spets, två laterala distala öppningar, ENFit-hankoppling med skruvlock.

PVC – Rekommenderad användningstid: 24t till 48t max.

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LOCK FÄRGKODAT FÄSTE	LÄNGD (cm)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE04P	4	Lila	40	40	640
NCE104P	4	Lila	125	40	640
NCE05P	5	Ljusgrå	50	40	640
NCE105P	5	Ljusgrå	125	40	640
NCE06P	6	Ljusgrön	50	40	640
NCE106P	6	Ljusgrön	125	40	640
NCE08P	8	Blå	50	40	640
NCE108P	8	Blå	125	40	640
NCE10P	10	Mörkgrå	50	40	640
NCE110P	10	Mörkgrå	125	40	640



PU – Rekommenderad användningstid: 29 dagar max.

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LOCK FÄRGKODAT FÄSTE	LÄNGD (cm)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE04PU	4	Lila	40	40	640
NCE104PU	4	Lila	125	40	640
NCE05PU	5	Ljusgrå	50	40	640
NCE105PU	5	Ljusgrå	125	40	640
NCE06PU	6	Ljusgrön	50	40	640
NCE106PU	6	Ljusgrön	125	40	640
NCE08PU	8	Blå	50	40	640
NCE108PU	8	Blå	125	40	640
NCE10PU	10	Mörkgrå	50	40	640
NCE110PU	10	Mörkgrå	125	40	640



PU, röntgentät sond - Rekommenderad användningstid: 29 dagar max.

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LOCK FÄRGKODAT FÄSTE	LÄNGD (cm)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE306PU	6	Ljusgrön	110	40	640
NCE308PU	8	Blå	110	40	640
NCE310PU	10	Mörkgrå	110	40	640
NCE312PU	12	Vit	110	40	640



NUTRICAIR® ENTERAL NASOGASTRISKA SONDER - VUXEN



Röntgentät sond i PU, markeringar vid varje centimeter, siffermarkeringar vid var 5:e centimeter, sluten rundad spets, fyra laterala distala öppningar, ENFit-hankoppling med skruvlock och färgkodat fäste per French-storlek.

NUTRICAIR® Enteral Nasogastrisk sond

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LOCK FÄRGKODAT FÄSTE	LÄNGD (cm)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE106AU	6	Ljusgrön	110	20	320
NCE506AU	6	Ljusgrön	130	20	320
NCE108AU	8	Blå	110	20	320
NCE508AU	8	Blå	130	20	320
NCE110AU	10	Mörkgrå	110	20	320
NCE510AU	10	Mörkgrå	130	20	320
NCE112AU	12	Vit	110	20	320
NCE512AU	12	Vit	130	20	320
NCE114AU	14	Mörkgrön	110	20	320
NCE514AU	14	Mörkgrön	130	20	320
NCE116AU	16	Orange	110	20	320
NCE516AU	16	Orange	130	20	320
NCE118AU	18	Röd	110	20	320
NCE518AU	18	Röd	130	20	320
NCE120AU	20	Gul	110	20	320
NCE520AU	20	Gul	130	20	320

NUTRICAIR® Enteral Nasogastrisk sond, med ledare

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LOCK FÄRGKODAT FÄSTE	LÄNGD (cm)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE106G	6	Ljusgrön	110	20	320
NCE506G	6	Ljusgrön	130	20	320
NCE108G	8	Blå	110	20	320
NCE508G	8	Blå	130	20	320
NCE110G	10	Mörkgrå	110	20	320
NCE510G	10	Mörkgrå	130	20	320
NCE112G	12	Vit	110	20	320
NCE512G	12	Vit	130	20	320
NCE114G	14	Mörkgrön	110	20	320
NCE514G	14	Mörkgrön	130	20	320
NCE116G	16	Orange	110	20	320
NCE516G	16	Orange	130	20	320

NUTRICAIR® Enteral Naso-duodenal sond med vikt

Tre laterala
distala öppningar.

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LOCK FÄRGKODAT FÄSTE	LÄNGD (cm)	VIKT (g)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE206AU	6	Ljusgrön	110	1,1	20	320
NCE208AU	8	Blå	110	1,1	20	320
NCE210AU	10	Mörkgrå	110	1,7	20	320
NCE212AU	12	Vit	110	2,8	20	320
NCE214AU	14	Mörkgrön	110	4,0	20	320

NUTRICAIR® Enteral Naso-duodenal sond med vikt och ledare

Tre laterala
distala öppningar.

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LOCK FÄRGKODAT FÄSTE	LÄNGD (cm)	VIKT (g)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE206G	6	Ljusgrön	110	1,1	20	320
NCE208G	8	Blå	110	1,1	20	320
NCE210G	10	Mörkgrå	110	1,7	20	320
NCE212G	12	Vit	110	2,8	20	320
NCE214G	14	Mörkgrön	110	4,0	20	320

NUTRICAIR® Enteral Naso-jejunal sond med vikt och ledare

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LOCK FÄRGKODAT FÄSTE	LÄNGD (cm)	VIKT (g)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE306G	6	Ljusgrön	130	2,8	20	320
NCE308G	8	Blå	130	2,8	20	320
NCE310G	10	Mörkgrå	130	4,0	20	320
NCE312G	12	Vit	130	4,0	20	320
NCE314G	14	Mörkgrön	130	4,8	20	320



NCE100GU

NUTRICAIR® Enteral Ledare för matningssond

ARTIKEL NR.	Ch/Fr	LÄNGD (cm)	AVD. FP	TRPT. FP
NCE100GU	6 - 18	110	20	320
NCE300GU	6 - 18	130	20	320

NUTRICAIR® ENTERAL SPRUTOR

Genomskinlig, lila kolv, dubbel markering för 5 ml, 10 ml, 20 ml och 50/60 ml, ENFit- honkoppling



NUTRICAIR® Enteral Sprutor

ARTIKEL NR.	VOLYM (ml)	SPETSPOSITION	AVD. FP	TRPT. FP
NCE01-V2SE	1	Low Dose Tip, centrisk	100	1600
NCE02SE	2.5	Low Dose Tip, centrisk	50	800
NCE05SE	5	centrisk	50	800
NCE10SE	10	excentrisk	50	800
NCE20SE	20	excentrisk	50	400
NCE50SE	50/60	excentrisk	50	200

NUTRICAIR® Enteral Sprutor med lock

ARTIKEL NR.	VOLYM (ml)	SPETSPOSITION	ANTAL KORKAR	AVD. FP	TRPT. FP
NCE01SEC	1	Low Dose Tip, centrisk	1	50	800
NCE02SEC	2.5	Low Dose Tip, centrisk	1	50	800
NCE05SEC	5	centrisk	1	50	800
NCE10SEC	10	excentrisk	1	50	800
NCE20SEC	20	excentrisk	1	50	400
NCE50SEC	50/60	excentrisk	1	50	200

NUTRICAIR® Enteral Skruvkork

NCE201C



NCE221C



ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE201C	Skruvkork för spruta med ENFit-koppling x 1 enhet	200	3200
NCE208C	Skruvkork för spruta med ENFit-koppling x 8 enheter	480	7680
NCE221C	Skruvkork för spruta med ENFit-koppling x 1 enhet	200	3200
NCE228C	Skruvkork för spruta med ENFit-koppling x 8 enheter	480	7680


NUTRICAIR® Enteral Uppdragningsrör för medicinering, mjölk och andra enterala lösningar

Uppdragningsrör, ENFit-hankoppling

ARTIKEL NR.	MÅTT		AVD. FP	TRPT. FP
NCE05S	5 cm; Ø 0.8 mm	PE/PVC	150	2400
NCE05SO	5 cm; Ø 1.3 mm - Flexibelt rör	PU	150	2400
NCE10S	10 cm; Ø 0.8 mm	PE/PVC	150	1200
NCE15S	15 cm; Ø 2.15 mm	PVC	150	1200
NCE020S	20 cm; Ø 2.15 mm	PVC	100	800
NCE20S	25 cm; Ø 2.15 mm	PVC	100	800
NCE25S	25 cm; Ø 4.5 mm	PVC	100	800
NCE30SO	30 cm; Ø 1.3 mm - Flexibelt rör	PU	100	800

NUTRICAIR® Enteral Flaskkorkar för läkemedel

NCE20C



NCE302C



ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE20C	Kork till injektionsflaska Ø 20 mm	40	640
NCE100C	Trappformad kork Ø 11 - 21 mm	100	1600
NCE302C	Skruvkork Ø 28 mm	50	800

NUTRICAIR® Enteral ENFit kork för matningssond


ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE301C	ENFit kork för matningssond x 1	200	3200

NUTRICAIR® Enteral Övergångsadaptrar för enteral nutrition


ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE100A	Mjuk kon med lock - ENFit-hona	150	2400
NCE101A	Mjuk vid kon med lock - ENFit-hona	100	1200
NCE104A	ENFit-hane - trappformad koppling	100	1600
NCE105A	ENFit-hane - lång trappformad koppling	100	800
NCE400A	ENFit-hane - trappformad koppling (Ø 1,6 mm ; L = 30 cm)	75	600

NUTRICAIR® Enteral Förlängningsslang

ENFit-hane - ENFit-hona med kork



ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE1210E	Ø 1,6 mm; L = 100 cm	50	400
NCE1215E	Ø 1,6 mm; L = 150 cm	50	400
NCE1315E	Ø 2,8 mm; L = 150 cm	25	400
NCE1340E	Ø 2,8 mm; L = 400 cm	15	120

NUTRICAIR® Enteral 3-vägs kran




ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE300R	3-vägs: 2 ENFit-hanar, 1 ENFit-hona	50	800

NUTRICAIR® Enteral Y-portadapter



ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	AVD. FP	TRPT. FP
NCE100Y	2 ENFit-hanar och 1 ENFit-hona	100	1600
NCE101Y	1 ENFit-hane, 1 vid konformad och 1 trappformad koppling	50	800
NCE102Y	1 ENFit-hane, 1 konformad och 1 trappformad koppling	50	640

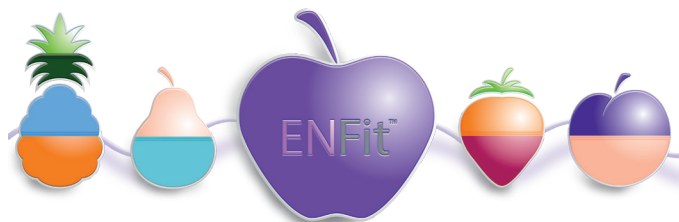

NUTRICAIR® ENTERAL

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

info.se@mediplast.com

www.mediplast.com

- 1• The Joint Commission, Managing risk during transition to new ISO tubing connector standards - Issue 53, August 20, 2014.
- 2• Advisor Live, New standards for medical tubing connectors: Are you ready? August 20, 2014.
- 3• Peggi Guenter, Rodney W. Hicks and Debora Simmons, Enteral Feeding Misconnections: An Update, Nutr Clin Pract 2009; 24; 325.
- 4• Peggi Guenter, New enteral connectors: raising awareness, Nutr Clin Pract Oct. 2014, Vol 29 Number 5, 612-614.
- 5• Rodney Hicks, Laura N. Provan, Preventing tubing misconnections: a practical view, Safes Practices in patient care, 2007.
- 6• ISO/TC 210/JWG 4 N 52, PG3 Summary Statement from ISO 80369-3 Clinical Group, Work Completed from June - August 2011.
- 7• ISO/TC 210/JWG 4 N 50, PG 3 report December 2011, ISO 80369 Joint Working Group 4 meeting, Swindon, UK December 13 - 15 2011.
- 8• NF EN ISO 80369-1 - Août 2011.
- 9• PR NF EN ISO 80369-3 - Novembre 2014.



RN6 Parc tertiaire de Bois Dieu - 1, allée des Chevreuils - 69380 Lissieu
Tél. +33 (0) 4 78 43 77 44
www.cairlgl.fr

Export Department
Tel. +33 (0) 4 72 54 72 21
Fax +33 (0) 4 78 43 77 09
export@cairlgl.fr